



THUASNE

SUR MESURE PATIENT



CEINTURES

COMMANDE (par défaut) DEVIS RENOUELEMENT

Client code

Dossier n° renouvellement

1^{er} traitement

Date : Quantité :

Nom du patient :

Prénom du patient :

Sexe : M F Enfant Taille du patient :

J'autorise mon professionnel de santé à collecter mes données et à les communiquer à la société Thuasne dans le cadre du traitement de la commande de mon dispositif médical sur mesure. Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, et au règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016, je bénéficie de droits dont notamment les droits d'accès, de rectification, de portabilité et de suppression de mes données. Je peux exercer ces droits en m'adressant par email à l'adresse en bas de page.

SIGNATURE DU PATIENT

IDENTIFICATION DU DÉTAILLANT

Dans la mesure du possible, merci de joindre des photos du membre à appareiller.
Dessiner les contours du vêtement sur le schéma et barrer les mesures inutiles.

Type de ceinture

- CML
- CMAL
- CMLR

Repères anatomiques

- D 9
- D 12

Adjonctions

La ceinture est livrée avec l'adjonction sangle de rappel 201E02.072
 Cochez ici si vous ne la souhaitez pas

- Bretelles 201E02.02
- Jarretelles 201E02.09
- Patte entrejambe 201E02.12
- Pelote pour hernie 201E02.15
- Sous-cuisse élastique 201E02.17
- Tirant hypogastrique (dos) 201E02.18
- Dispositif pour stomie (sur CMAL uniquement) 201E02.05

Merci d'indiquer son positionnement sur le schéma

Merci d'indiquer son positionnement sur le schéma

NE PEUT ÊTRE RÉALISÉE QU'APRÈS L'ESSAYAGE

- Patte hypogastrique (devant) 201E02.18

Fermeture CMAL

- Droite
- Gauche
- Centrale

Fermeture centrale uniquement pour les modèles CML/CMLR

Commentaires



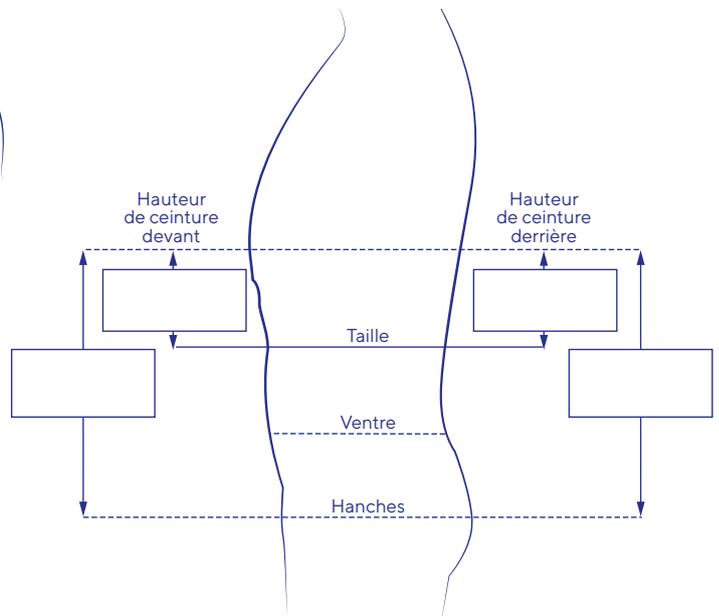


Schéma de positionnement stomie/hernie

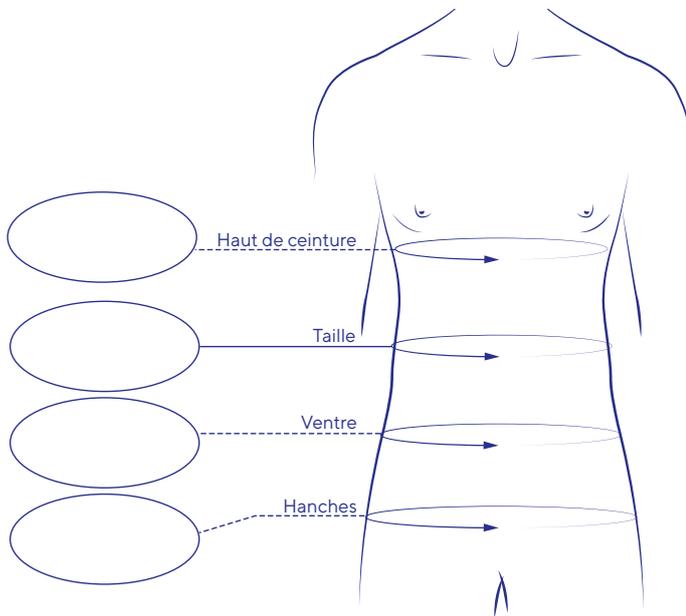

Circonférence en cm Hauteur en cm